

(19) 日本国特許庁(JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11) 特許出願公開番号

特開2005-300479
(P2005-300479A)

(43) 公開日 平成17年10月27日(2005.10.27)

(51) Int. Cl. ⁷	F I	テーマコード (参考)
GO 1 T 1/20	GO 1 T 1/20	2 G O 8 8
CO 9 K 11/00	CO 9 K 11/00	4 H O O 1
CO 9 K 11/08	CO 9 K 11/08	E
CO 9 K 11/56	CO 9 K 11/56	C P C
GO 1 T 3/06	GO 1 T 3/06	
審査請求 未請求 請求項の数 6 O L (全 9 頁)		

(21) 出願番号	特願2004-120790 (P2004-120790)	(71) 出願人	000004097 日本原子力研究所 千葉県柏市末広町14番1号
(22) 出願日	平成16年4月15日(2004.4.15)	(74) 代理人	100089705 弁理士 社本 一夫
		(74) 代理人	100076691 弁理士 増井 忠式
		(74) 代理人	100075270 弁理士 小林 泰
		(74) 代理人	100080137 弁理士 千葉 昭男
		(74) 代理人	100096013 弁理士 富田 博行
		(74) 代理人	100092015 弁理士 桜井 周矩
		最終頁に続く	

(54) 【発明の名称】 ZnS蛍光体を用いた粒子線検出器及び中性子検出器

(57) 【要約】


【課題】

ガンマ線に感度が低く、高計数率測定に対応した粒子線検出器を提供する。

【解決手段】

ZnS:Ag, Cl 蛍光体が、粒子線に対する蛍光量が非常に大きく検出が容易に行うことが可能であることをそのまま利用し、新しく見つけ出した波長が短い波長領域の蛍光寿命が短い現象を利用して計数特性を改善し、粒子線の高計数率測定を実現する。光学フィルタとしてB370を用い、450nmより短い蛍光波長を取り出し場合、短い蛍光寿命成分の蛍光寿命を370nsから200nsに改善することができた。

【選択図】 図1

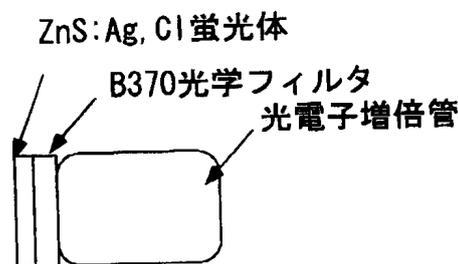

【特許請求の範囲】

【請求項 1】

X が塩素 (Cl) あるいはアルミニウム (Al) である ZnS : Ag, X 蛍光体から放出される蛍光のうち、波長が短い波長領域の蛍光寿命が短いことを利用して計数特性を改善することを特長とした粒子線検出器。

【請求項 2】

X が塩素 (Cl) あるいはアルミニウム (Al) である ZnS : Ag, X 蛍光体に、中性子コンバータとして、 ^6Li あるいは ^{10}B を混合した中性子検出器において、この蛍光体から放出される蛍光のうち、波長が短い波長領域の蛍光寿命が短いことを利用して計数特性を改善することを特長とした中性子検出器。

10

【請求項 3】

ZnS : Ag, Cl 蛍光体から放出される蛍光のうち、波長が短い波長領域の蛍光量が、粒子線の蛍光量に比較し、ガンマ線あるいは電子線の蛍光量が少なくなることを利用して、ガンマ線あるいは電子線を弁別して粒子線を検出することを特長とした粒子線検出器。

【請求項 4】

ZnS : Ag, Cl 蛍光体に、中性子コンバータとして、 ^6Li あるいは ^{10}B を混合した中性子検出器において、この蛍光体から放出される蛍光のうち、波長が短い波長領域の蛍光量が、中性子の蛍光量に比較し、ガンマ線あるいは電子線の蛍光量が少なくなることを利用して、ガンマ線あるいは電子線を弁別して中性子を検出することを特長とした中性子検出器。

20

【請求項 5】

請求項 3 乃至 4 のいずれかにおいて、ZnS : Ag, Cl 蛍光体から放出される蛍光のうち、波長が短い波長領域と長い領域の蛍光をそれぞれ検出し、ガンマ線あるいは電子線も弁別し同時に計数可能とすることを特長とした粒子線検出器及び中性子検出器

【請求項 6】

請求項 1 乃至 5 のいずれかにおいて、蛍光波長領域の選択のために、波長シフトファイバを用いることを特長とした粒子線検出器及び中性子検出器。

30

【発明の詳細な説明】

【技術分野】

【0001】

本発明は、ZnS 蛍光体を用いた粒子線検出器及び中性子検出器において、その計数特性を改善することに関する。

40

【従来技術】

【0002】

従来、アルファ線などの粒子線検出器、あるいは中性子コンバータである ^6Li あるいは ^{10}B を介し放出される粒子線を検出することにより中性子を検出する中性子検出器には、粒子線に対する蛍光量が非常に大きく、かつ蛍光寿命のうち短い蛍光寿命の成分が 200 から 300 ns と短いことから、ZnS 蛍光体が主に使用されてきた。

【0003】

しかし、ZnS 蛍光体の蛍光寿命には、図 12 に示すようにアフターグローと呼ばれて

50

いる遅い蛍光寿命成分が含まれている。このため、平均の蛍光寿命は70から100 μ sといわれている。この遅い蛍光寿命成分が原因となり、高い計数率の粒子線あるいは中性子が入射するとパイルアップ現象を起こし、正確に計数率を測定することが困難になるという欠点があった(非特許文献1)。

【非特許文献1】放射線ハンドブック第2版

【発明の開示】

【発明が解決しようとする課題】

【0004】

大強度陽子加速器を用いた大強度パルス中性子源が最近使用されるようになり、パルス中性子の強度および発生する中性子エネルギー範囲が広がるにつれ、高計数率に対応し、検出器を飽和させることなく、かつ簡便に中性子の検出及び2次元中性子イメージが可能な検出器の開発が不可欠である。また、同じく加速器あるいは原子炉を用いた実験においても、粒子線の高計数率測定が不可欠である。また、これらの中性子あるいは粒子線を測定する場合、ガンマ線バックグラウンドの影響を軽減した検出も同時に不可欠である。さらに、ダークマター(暗黒物質)あるいは宇宙線観測には、ガンマ線バックグラウンドをできる限り減らした粒子線検出が不可欠である。

10

【課題を解決するための手段】

【0005】

本発明においては、ZnS:AgあるいはZnS:CuなどのZnS蛍光体が、粒子線に対する蛍光量が非常に大きく検出を容易に行うことが可能であることをそのまま利用し、新しく見つけ出した波長が短い波長領域の蛍光寿命が短い現象を利用して計数特性を改善し、粒子線あるいは中性子の高計数率測定を実現する。また、ガンマ線あるいは電子線の弁別には、新しく見つけ出したZnS:Ag, Cl蛍光体から放出される蛍光のうち、波長が短い波長領域の蛍光量が、粒子線の蛍光量に比較し、ガンマ線あるいは電子線の蛍光量が少なくなる現象を利用する。

20

[実施例]

【0006】

以下、本発明を実施例に基づいて説明する。

【実施例1】

【0007】

実施例1として、蛍光体としてZnS:Ag, Cl蛍光体を用いた粒子線検出器について、図1を参照して述べる。

30

図1は、粒子線検出用としてZnS:Ag, Clを用い、その背後に光学フィルタとして450nm付近から短波長を通すB370配置し、その背後に光電子増倍管を配置した構造の粒子線検出器の実施例である。

まず、ZnS:Ag, Clの蛍光寿命の波長依存性を図2に示す回路により測定した。粒子線線源として5.4MeVのアルファ線を放出するAM-241線源を用いた。ZnS:Ag, Cl蛍光体は有機系接着剤と混合しガラス板に塗布している。塗布量は5mg/cm²である。その後、ZnS:Ag, Clから放出される蛍光を波長通過特性の異なる光学フィルタを用いて選別し光電子増倍管(浜松ホトニクス:R647P)を用いて検出し、信号波形をデジタルオシロスコープで測定した。測定した信号波形を解析し蛍光寿命を求めた結果を表1示す。蛍光寿命を求める際の蛍光寿命解析領域としては0.8 μ sを用いた。蛍光の短い波長領域が、短い蛍光寿命を示す事が確認できた。

40

【0008】

【表 1】

表 1 波長通過特性の異なる光学フィルタを用いた場合の蛍光寿命特性

光学フィルタ	透過範囲	蛍光寿命 (ns)
光学フィルタなし		362
FV026	380-420 nm	125
B370	350-450 nm	176
B390	350-470 nm	258
Y440	440 nm以上	418

10

【0009】

本実施例のように、光学フィルタとして450 nm付近から短波長を通すB370を用い蛍光量をあまり減らすことなく蛍光寿命の短縮を図った場合、図3に示す信号波形のように、光学フィルタを用いない場合の蛍光寿命362 nsに比較し、176 nsと改善されることがわかった。ZnS:Ag, Al蛍光体についても同様の実験を行い、光学フィルタを用いない場合の蛍光寿命421 nsに比較し、292 nsと改善されることを確認した。

【実施例2】

20

【0010】

実施例2として、ZnS:Ag, Cl蛍光体に、中性子コンバータとして、 ^6LiF を混合した中性子検出用シンチレータを用い、このシンチレータから放出される蛍光のうち、波長が短い波長領域の蛍光寿命が短いことを利用して計数特性を改善した中性子検出器について、図4を参照して述べる。

図4は、中性子検出用シンチレータとしてZnS:Ag, Clと中性子コンバータとし、 ^6LiF を用いその背後に光学フィルタとして450 nm付近から短波長を通すB370を配置し、その背後に光電子増倍管(浜松ホトニクス:R647P)を配置した構造の粒子線検出器の実施例である。

ZnS:Ag, Clの蛍光寿命の波長依存性は図2に示すとおりである。中性子検出用シンチレータとしては、ZnS:Ag, Clを 60 mg/cm^2 、中性子コンバータである ^6LiF については 15 mg/cm^2 を有機系接着剤と混合しアルミニウム板に塗布して製作した。中性子検出用シンチレータ装着後、中性子源としてAm-Li線源を用いて熱中性子を検出器に照射した。ZnS:Ag, Clから放出される蛍光の信号波形はデジタルオシロスコープで測定した。本実施例のように、光学フィルタとして450 nm付近から短波長を通すB370を用い蛍光量をあまり減らすことなく蛍光寿命の短縮を図った場合、図5に示す信号波形のように、光学フィルタを用いない場合の蛍光寿命391 nsに比較し、238 nsと改善されることがわかった。蛍光寿命を求める際の蛍光寿命解析領域としては $0.8\text{ }\mu\text{s}$ を用いた。

30

【実施例3】

40

【0011】

実施例3として、蛍光体としてZnS:Ag, Cl蛍光体を用い、ガンマ線を弁別して粒子線を検出する粒子線検出器について、図6を参照して述べる。

図6は、粒子線検出用としてZnS:Ag, Clを用い、その背後に光学フィルタとして420 nm付近から短波長を通すFV026(フィルター番号)を配置し、その背後に光電子増倍管を配置した構造のガンマ線を弁別することを可能とした粒子線検出器の構成図である。

ZnS:Ag, Cl蛍光体について、アルファ線とガンマ線を用いて蛍光波長スペクトルが変化することを確認する実験を行った。アルファ線としては、Am-241線源から放出される 5.4 MeV のアルファ線を用い、ガンマ線としてAm-241線源から放出さ

50

れる60 keVのガンマ線を薄い板を線源の表面に置きアルファ線の影響を取り除いてから用いた。実験結果を図7に示す。エネルギーによる差をとり除くため規格化してプロットしている。この結果より、放出される蛍光のうち、波長が短い波長領域の蛍光量が、粒子線の蛍光量に比較し、ガンマ線の蛍光量が少なくなることが確認できた。特に、420 nm以下で差が大きくなることが確認できたことから。このため、本実施例では、上記に述べた光学フィルタとしてFV026を用いた。このような構成とすることによりガンマ線を弁別した粒子線検出が可能となる。

【実施例4】

【0012】

実施例4として、ZnS:Ag, Cl蛍光体に、中性子コンバータとして、 ^6LiF を混合した中性子検出用シンチレータを用い、ガンマ線を弁別して中性子を検出する中性子検出器について、図8を参照して述べる。

中性子用シンチレータとしてZnS:Ag, Cl蛍光体に、中性子コンバータとして、 ^6LiF を混合したシンチレータを用いた。透過度を良くするためがあるため、本実施例ではZnS:Ag, Clを 20 mg/cm^2 、中性子コンバータである ^6LiF については 5 mg/cm^2 を有機系接着剤と混合しアルミニウム板に塗布して製作した。本実施例では、光学フィルタとして、420 nm以下で差が大きくなることが確認できたことからFV026を用いた。このような構成とすることによりガンマ線を弁別した中性子検出が可能となる。

【実施例5】

【0013】

実施例5として、ZnS:Ag, Cl蛍光体から放出される蛍光のうち、波長が短い波長領域と長い領域の蛍光をそれぞれ検出し、ガンマ線あるいは電子線も同時に弁別し計数可能とすることを特長とした粒子線検出器について図9を参照して述べる。

図9は、ZnS:Ag, Cl蛍光体の背後に蛍光を拡散し2カ所から蛍光を検出するために光拡散ブロックを用いた例である。片方は、短波長側を検出するため光学フィルタとして450 nm付近から短波長を通すB370を用い、もう一方は光学フィルタとして440 nm付近から長波長を通すY440を用いる。光学フィルタの後に配置した2つの光電子増倍管(浜松ホトニクス:R647P)から出力された短波長側の信号と長波長側の信号との比を割り算回路で求め、求めた結果の信号を波高弁別回路を通すことにより、比が大きい場合には粒子線であり、比が小さい場合にはガンマ線であることを利用してガンマ線と粒子線を弁別して計数することができる。

【実施例6】

【0014】

実施例6として、蛍光波長領域の選択のために、波長シフトファイバを用いることを特長とした粒子線検出器について図10を参照して述べる。

図10は、粒子線検出用としてZnS:Ag, Clを用い、その背後に380 nmから420 nmにかけて吸収波長帯を持つ米国Bicron社製特注波長シフトファイバBCF-99-33を配置した粒子検出器の例である。図11に示すようにZnS:Ag, Clの蛍光スペクトルの短波長領域と、特注の波長シフトファイバBCF-99-33の吸収スペクトル領域が良く一致するため、ガンマ線の影響を少なくした粒子検出器を構成することができる。

【図面の簡単な説明】

【0015】

【図1】粒子線検出用としてZnS:Ag, Clを用いその背後に光学フィルタとして450 nm付近から短波長を通すB370を配置し、その背後に光電子増倍管を配置した構造の粒子線検出器を示す図である。

【図2】ZnS:Ag, Clの蛍光寿命の波長依存性を測定する回路の図である。

【図3】粒子線検出用としてZnS:Ag, Clを用い光学フィルタとしてB370を用いた場合と用いない場合の光電子増倍管から出力された粒子線に対する信号波形の比較図

10

20

30

40

50

である。

【図4】 ZnS : Ag , Cl 蛍光体に、中性子コンバータとして、⁶LiF を混合した中性子検出用シンチレータを用い、光学フィルタとして450nm付近から短波長を通すB370を配置し、その背後に光電子増倍管を配置した構造の中性子検出器を示す図である。

【図5】 中性子検出用としてZnS : Ag , Clを用い、光学フィルタとしてB370を用いた場合と用いない場合の光電子増倍管から出力された中性子に対する信号波形の比較図である。

【図6】 粒子線検出用としてZnS : Ag , Clを用い、その背後に光学フィルタを配置し、その背後に光電子増倍管を配置した構造のガンマ線を弁別した粒子線検出器の構成を示す図である。

【図7】 ZnS : Ag , Cl 蛍光体のアルファ線とガンマ線に対する蛍光波長スペクトルの比較を示す図である。

【図8】 ZnS : Ag , Cl 蛍光体に、中性子コンバータとして、⁶LiF を混合した中性子検出用シンチレータを用い、ガンマ線を弁別して中性子を検出する中性子検出器の構成を示す図である。


【図9】 ZnS : Ag , Cl 蛍光体から放出される蛍光のうち、波長が短い波長領域と長い領域の蛍光をそれぞれ検出し、ガンマ線も同時に弁別し計数可能とした粒子線検出器の構成を示す図である。

【図10】 蛍光波長領域の選択のために、波長シフトファイバを用いることを特長とした粒子線検出器の構成を示す図である。


【図11】 ZnS : Ag , Cl 蛍光体の蛍光スペクトルの短波長領域と、波長シフトファイバBCF - 99 - 33の吸収スペクトル領域の比較を示す図である。

【図12】 従来のZnS : Ag , Cl 蛍光体のアルファ線に対する信号波形を示す図である。


【図1】

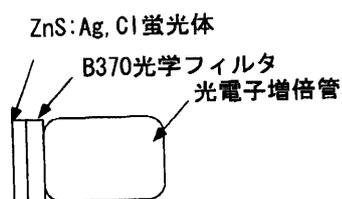

【図2】

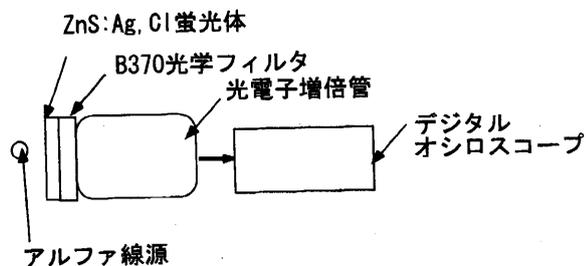


【図3】

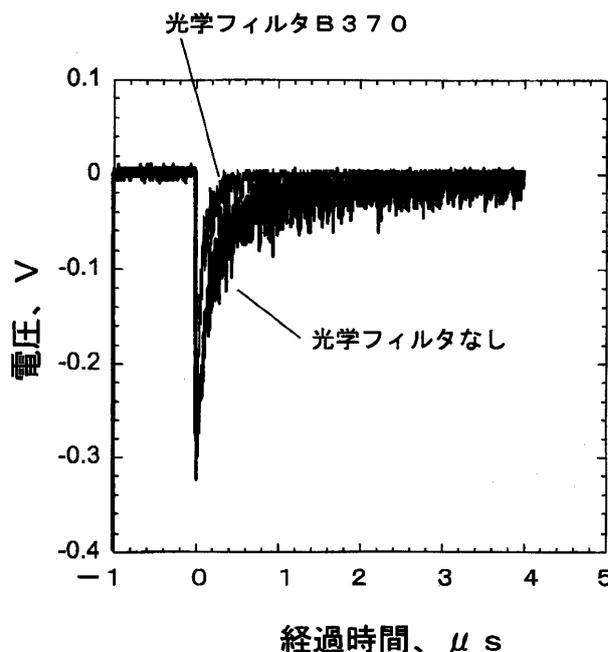


10

20


【 図 4 】

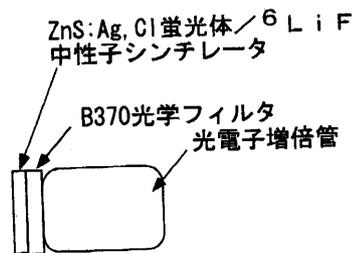


【 図 5 】

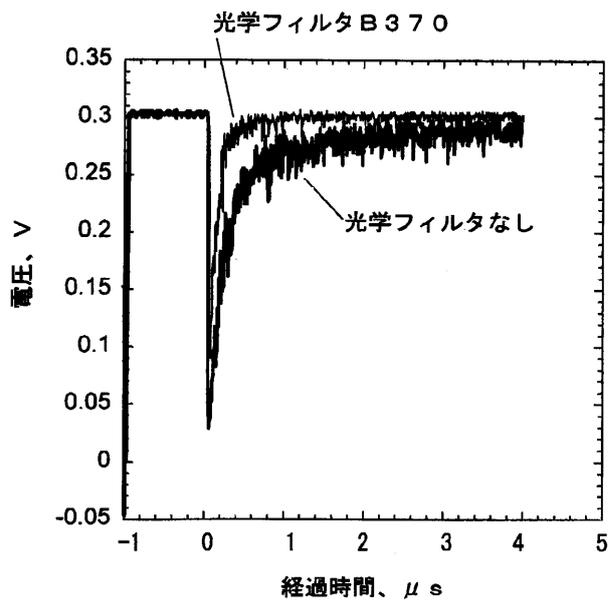


【 図 6 】

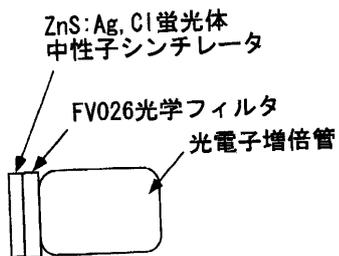


【 図 7 】

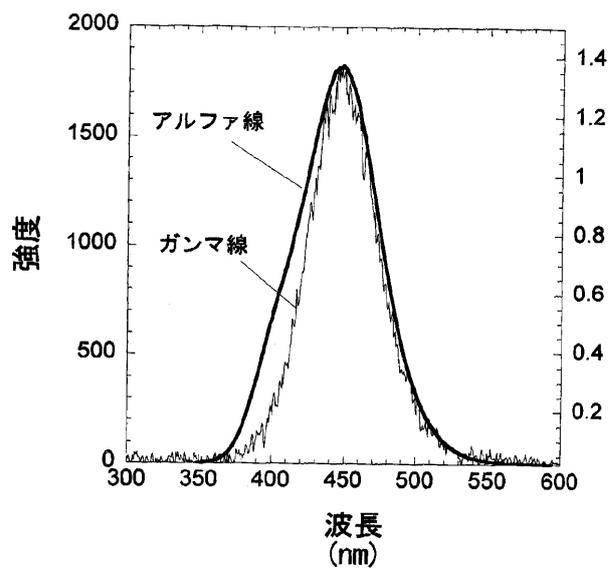


【 図 8 】

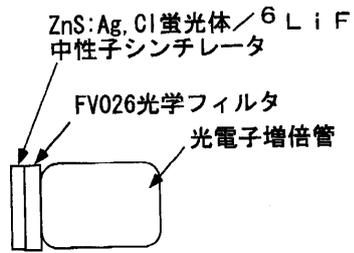


【 図 10 】

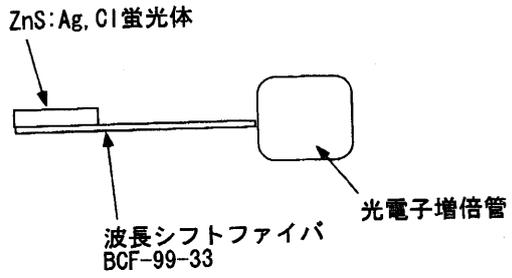


【 図 9 】

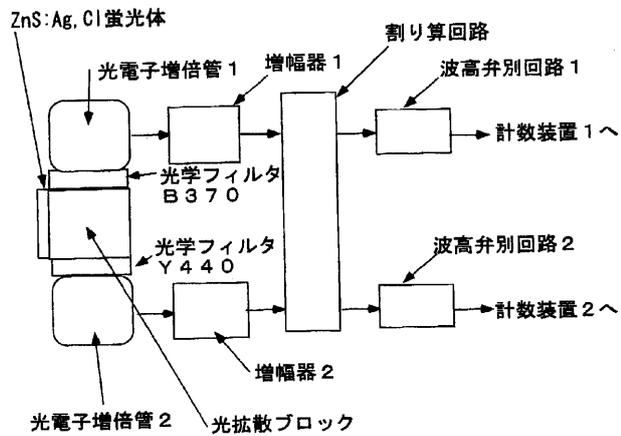

【 図 11 】

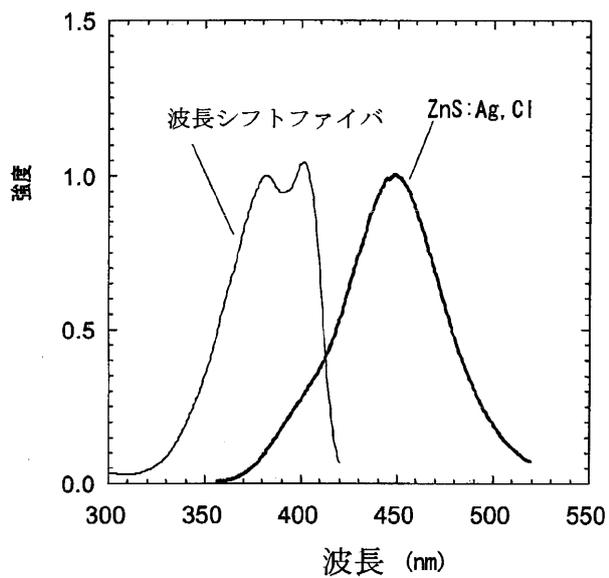

【 図 12 】

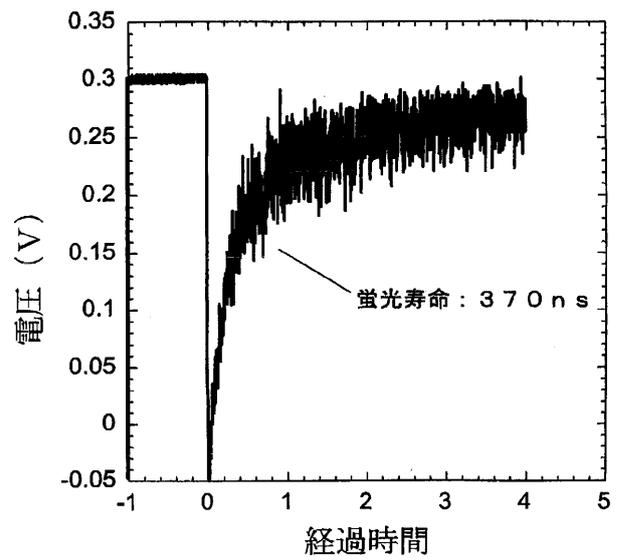

フロントページの続き

(72)発明者 片桐 政樹

茨城県那珂郡東海村白方字白根2番地の4 日本原子力研究所 東海研究所内

Fターム(参考) 2G088 EE30 FF04 FF05 FF06 FF09 GG10 GG15 GG18 KK01 KK02

KK13 KK16 LL02 LL15

4H001 CA04 CA08 XA16 XA30 YA13 YA17 YA47